



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat  
Centrala  
Fax  
e-mail:

67 210 62 05  
67 210 66 66  
67 212 40 85  
kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 10.06.2025 roku

EZP.III-241/31/25

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**BEZPIECZNY SPRZĘT MEDYCZNY DO PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytanie nr 1.**

zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści krótki dren bursztynowy o długości 35 cm +/- 2 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 2.**

zadanie 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści krótki dren bursztynowy z filtrem z dwoma zaciskami na drenie (jeden przed filtrem, drugi za filtrem)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 3.**

zadanie 3, pozycja 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z dwoma zaciskami klamrowymi na linii (jeden pod igła biorczą, drugi na końcu drenu) oraz z zaciskiem rolkowym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 4.**

zadanie 7, pozycja 1-7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania do leków cytotoksycznych? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odstąpienie od powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert co przełoży się na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje**

#### **Pytanie nr 5.**

Zadanie nr 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 6 worków do ochrony przed światłem :  
poz. 2 – 500 ml ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie nr 6.**

Pakiet 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 1 i 2 dopuści linię boczną infuzyjną wykonaną dwuwarstwowo: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna (nie mająca kontaktu z płynem) wykonana z PCV bez ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie nr 7.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 1 dopuści linię boczną infuzyjną o długości całkowitej 33,5 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści linię boczną infuzyjną o długości całkowitej 37 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wymaga aby dodatkowe bezigłowe porty posiadały gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracowały w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną. Port bezigłowy powinien być o bardzo małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) przeznaczonym na 400 aktywacji lub 7 dni?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 10.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 1, 2 i 3 dopuści linię infuzyjną grawitacyjną wykonaną dwuwarstwowo: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna (nie mająca kontaktu z płynem) wykonana z PCV bez ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**


**Pytanie nr 11.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wymaga aby dodatkowe bezigłowe porty posiadały gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracowały w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną. Port bezigłowy powinien być o bardzo małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) przeznaczonym na 400 aktywacji lub 7 dni?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 12.**


Dotyczy Pakietu nr 2 Poz.1 Czy Zamawiający dopuści długość linii (nie wliczając w to kolca) 35 cm? Długość całego zestawu wraz z kolcem ~38-40 cm. Pozostałe parametry zgodne z swz.

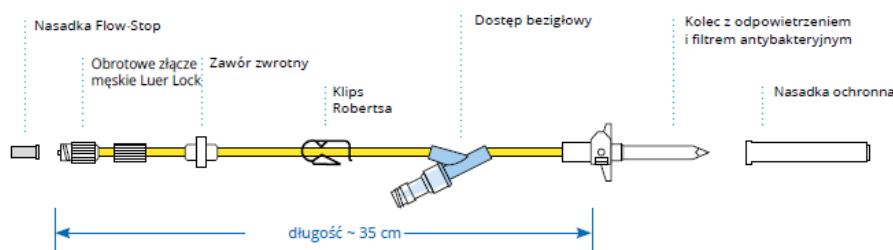

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 13.**

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści długość linii (nie wliczając w to kolca) 35 cm? Długość całego zestawu wraz z kolcem ~38-40 cm. Pozostałe parametry zgodne z swz.

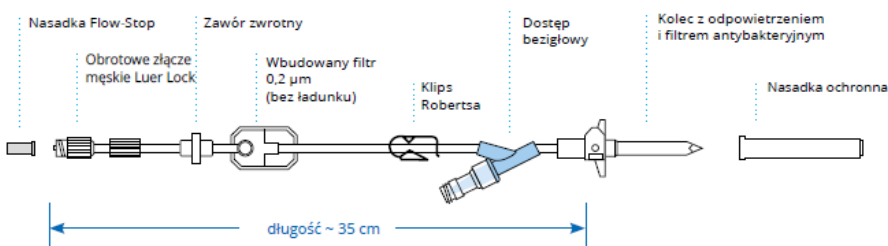

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 14.**

Ad. § 11 Prosimy o dodanie w § 11, pkt. 3. Dodatkowego punktu umożliwiającego zmianę numeru katalogowego produktu, bez jednoczesnej zmiany właściwości technicznych lub nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w umowie produkt zamienny o parametrach tożsamy lub jakościowo lepszy.**

**Pytanie nr 15.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 oraz 3: 1.W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanej części faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części faktury za daną dostawę.

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części zadania, której dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części zadania, której dotyczą niedostarczone dokumenty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umownych**

**Pytanie nr 16.**

Pytania do zadania nr. 2 Czy Zamawiający w punkcie 1, dopuści dren o następujących parametrach:

Krótki dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych z możliwością ich podaży poprzez podłączenie do linii infuzyjnej głównej. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Dodatkowo port bezigłowy w linii. Bez: DEHP oraz lateksu, PCV Medyczne. Na drenie zacisk całkowicie blokujący przepływ płynu. Linia drenu o długości 30 cm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 17.**

Czy Zamawiający w punkcie 2, dopuści dren o następujących parametrach: 3.Krótki dren z filtrem 0,2 µm do przygotowywania leków cytostatycznych z możliwością ich podaży poprzez podłączenie do linii infuzyjnej głównej. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Dodatkowo port bezigłowy w linii. Bez: PCV, DEHP oraz lateksu. Na drenie zacisk całkowicie blokujący przepływ płynu. Linia drenu o długość 20 cm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 18.**

Pytania do zadania nr. 3 1.Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści dren o następujących parametrach:

Przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z jednym bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem, w części dystalnej dodatkowy port bezigłowy. Zestaw zawierający zacisk klamrowy oraz rolkowy. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Bez: DEHP oraz lateksu, PVC Medyczne. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 19.**

Pytania do zadania nr. 3 Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści dren o następujących parametrach:

Przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z dwoma bocznymi portami bezigłowymi nad komorą kroplową do podłączenia pojemników z lekiem, dodatkowo w części dystalnej port bezigłowy (razem 3 porty bezigłowe). Zestaw zawierający zacisk klamrowy oraz rolkowy. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Bez: DEHP oraz lateksu, PVC Medyczne. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 20.**

Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści dren o następujących parametrach:

Przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z czterema bocznymi portami bezigłowymi nad komorą kroplową do podłączenia pojemników z lekiem, dodatkowo w części dystalnej port bezigłowy (razem 5 portów bezigłowych). Zestaw zawierający zacisk klamrowy oraz rolkowy. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Bez: DEHP oraz lateksu, PVC Medyczne. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 21.**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno a nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu z zagranicy natomiast faktury z biura z Warszawy. Wysłanie towaru razem z fakturą jest w tym wypadku niemożliwie.

Niemniej do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, a faktura papierowa dostarczana jest niezwłocznie. Istnieje również możliwość przysyłania faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 22.**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 14 Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu dot. naliczania kary umownej, gdy wystąpił zakup interwencyjny. Zamawiający w przypadku zakupu interwencyjnego obciąży wykonawcę różnicą w cenie, zatem dodatkowe nakładanie kary jest nieuzasadnione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Pytanie nr 23.**

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu do umowy: W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

**Pytanie nr 24.**

Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 38cm z dwoma zaciskami na linii? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 25.**

Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o długości 55cm z dwoma zaciskami na linii? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26.**

Pytanie dotyczy zadania nr 3 poz 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z 2 portami bezigłowymi nad komorą kroplową i dodatkowym portem w części dystalnej oraz zastawką antyzwrotną pakowaną oddzielnie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 27.**

Pytanie dotyczy zadania nr 3 poz 2 i 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z zastawką antyzwrotną pakowaną oddzielnie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 28.**

Pytanie Zadanie 7 poz 4 Prosimy Zamawiającego w zadaniu 7 poz 4 o dopuszczenie strzykawki o pojemności 10ml bez rozszerzenia na 12ml. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 29.**

Pytanie Zadanie 7 poz 1-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora o braku przeciwwskazań do stosowania z lekami niebezpiecznymi, chyba że producent leku wskaże inaczej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 30.**

Pakiet nr 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml z podziałką co 0,1ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 31.**

Pakiet nr 7, pozycja 2-4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 32.**

Pakiet nr 7, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 10ml bez rozszerzenia do 12ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 33.**

Pakiet nr 7, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 20ml z podziałką co 0,5ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 34.**

Pakiet nr 7, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 35.**

Pakiet nr 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 36.**

Pakiet 7 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej kompatybilnej z lekami cytostatycznymi o pojemności 10 ml – bez rozszerzenia do 12 ml z podziałką co 0,2 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 37.**

Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkiego drenu bursztynowego bez zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 38.**

Zadanie nr 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkiego drenu z filtrem bez zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 39.**

Zadanie nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do podawania leków onkologicznych bez zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 40.**

Zadanie nr 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do podawania leków onkologicznych bez zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 41.**

Zadanie nr 3, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do podawania leków onkologicznych bez zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**